



## THE.MAGICLIGHT

Istruzioni di Montaggio | Dispositivo di Irradiazione Antisettica a Raggi Ultravioletti  
Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

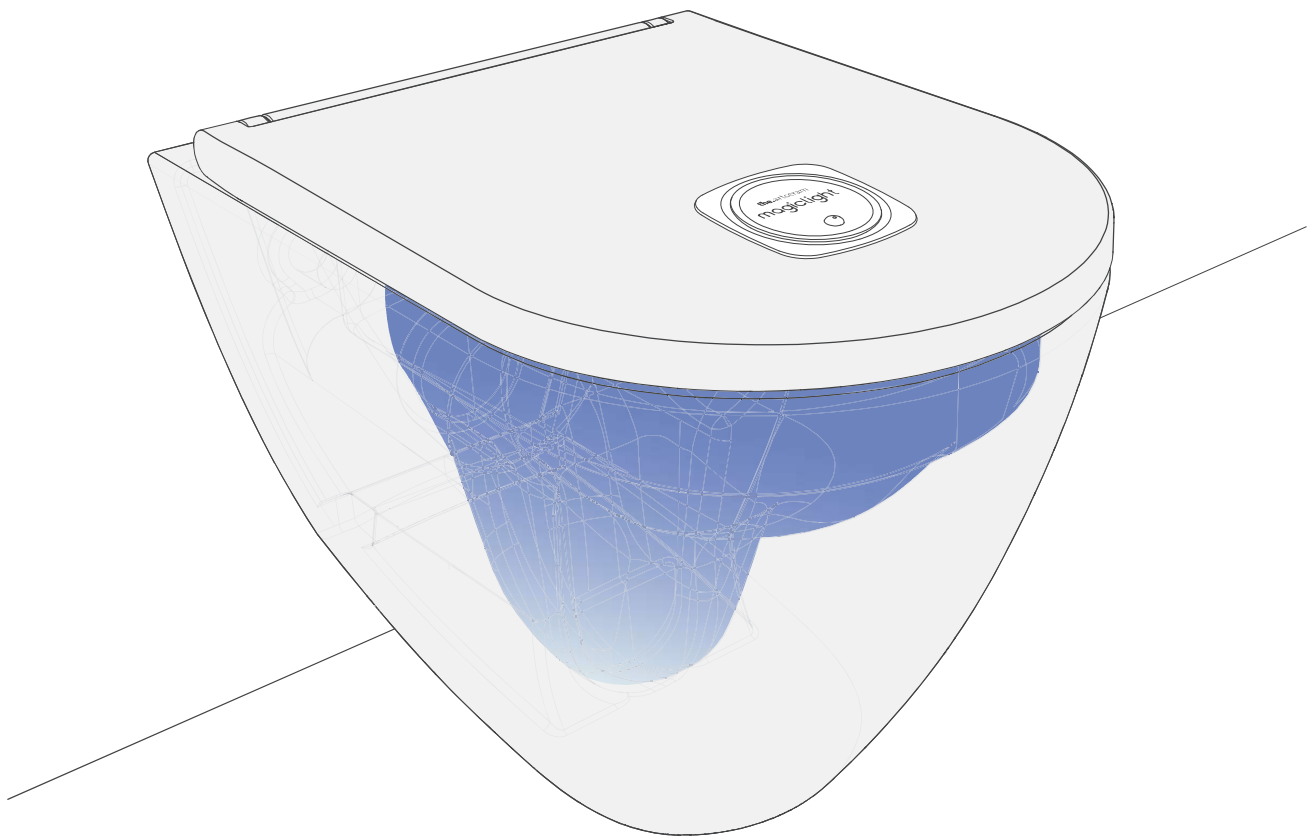


## THE.MAGICLIGHT

Istruzioni di Montaggio | Dispositivo di Irradiazione Antisettica a Raggi Ultravioletti  
Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

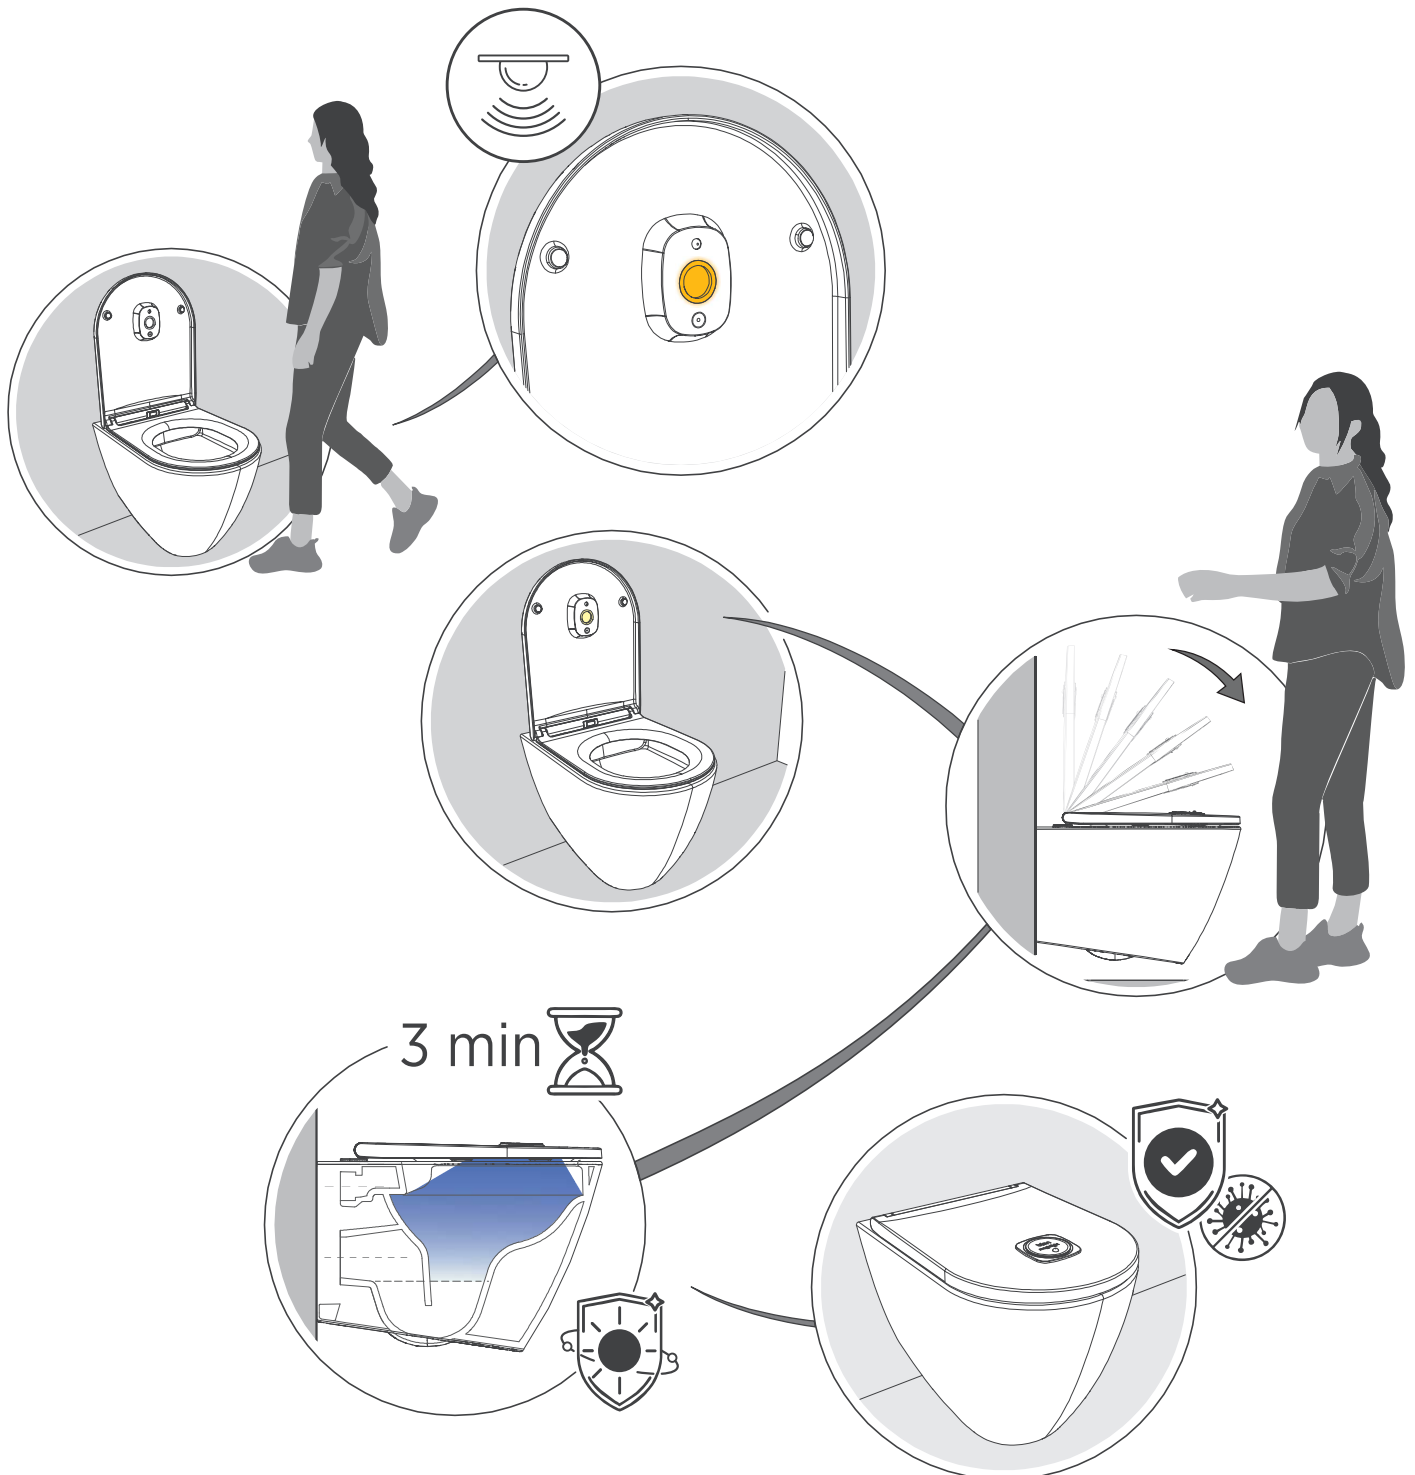

## THE.MAGICLIGHT

Istruzioni di Montaggio | Dispositivo di Irradiazione Antisetica a Raggi Ultravioletti  
Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

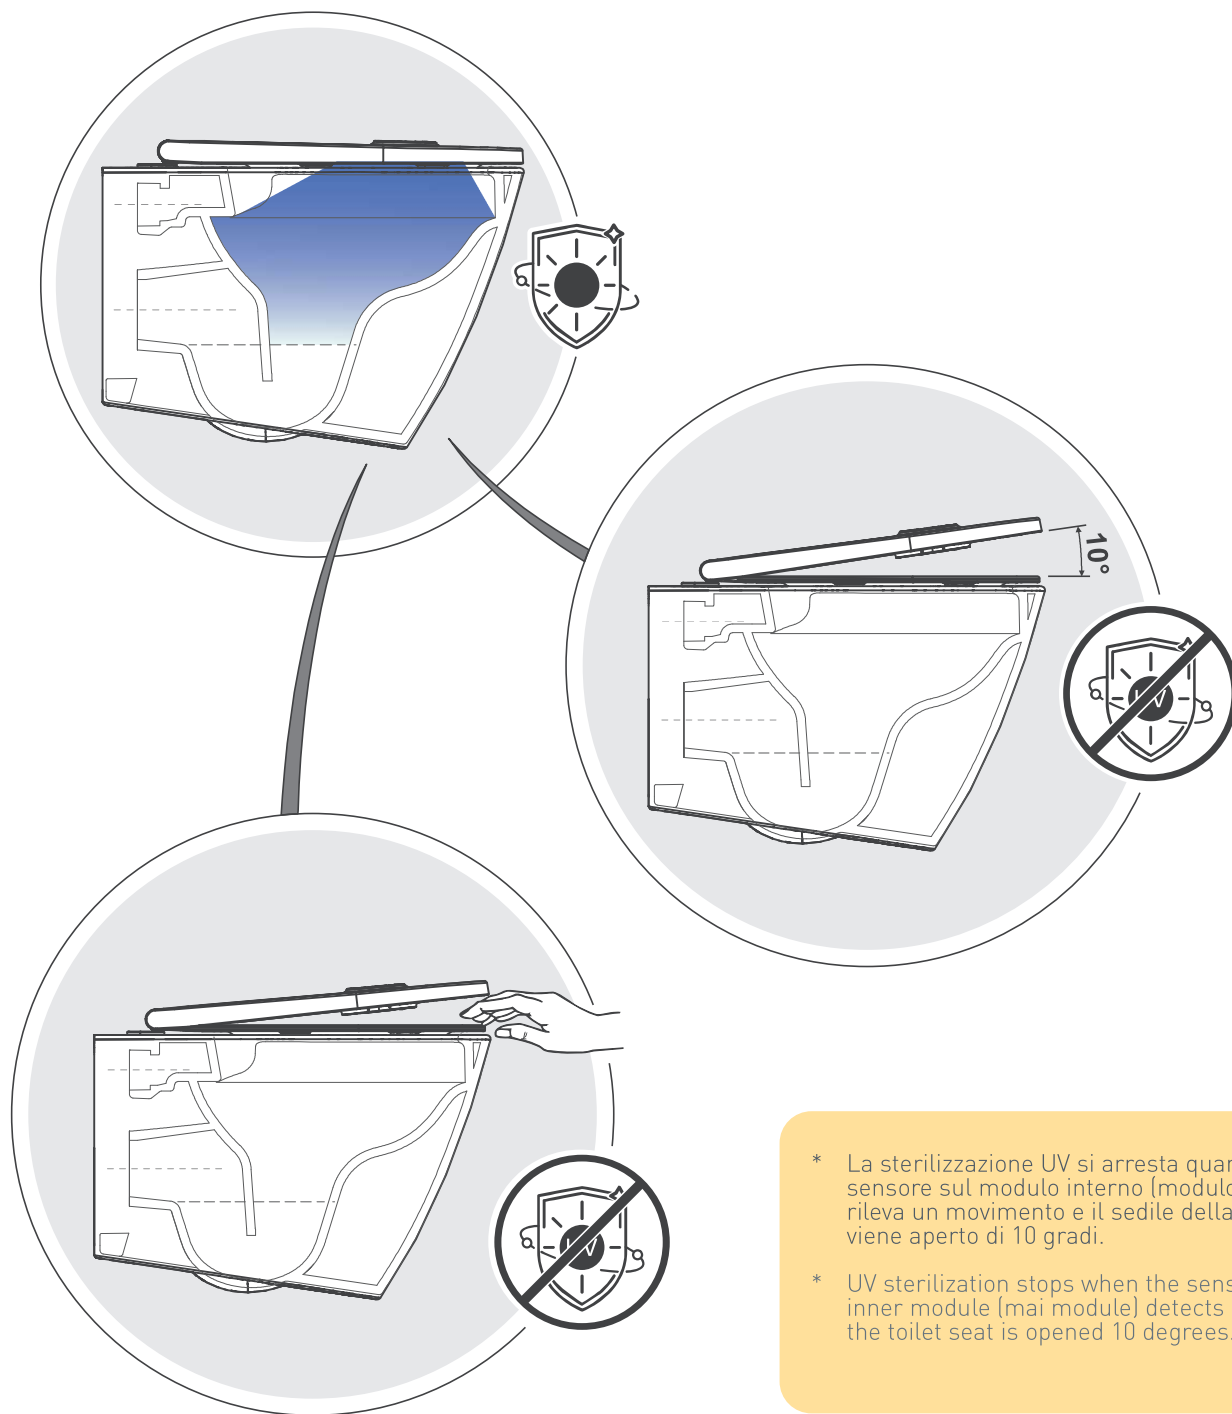


- \* La sterilizzazione UV si arresta quando il sensore sul modulo interno (modulo principale) rileva un movimento e il sedile della toilette viene aperto di 10 gradi.
- \* UV sterilization stops when the sensor in the inner module (main module) detects motion and the toilet seat is opened 10 degrees.




## THE.MAGICLIGHT

Istruzioni di Montaggio | Dispositivo di Irradiazione Antisetica a Raggi Ultravioletti  
Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

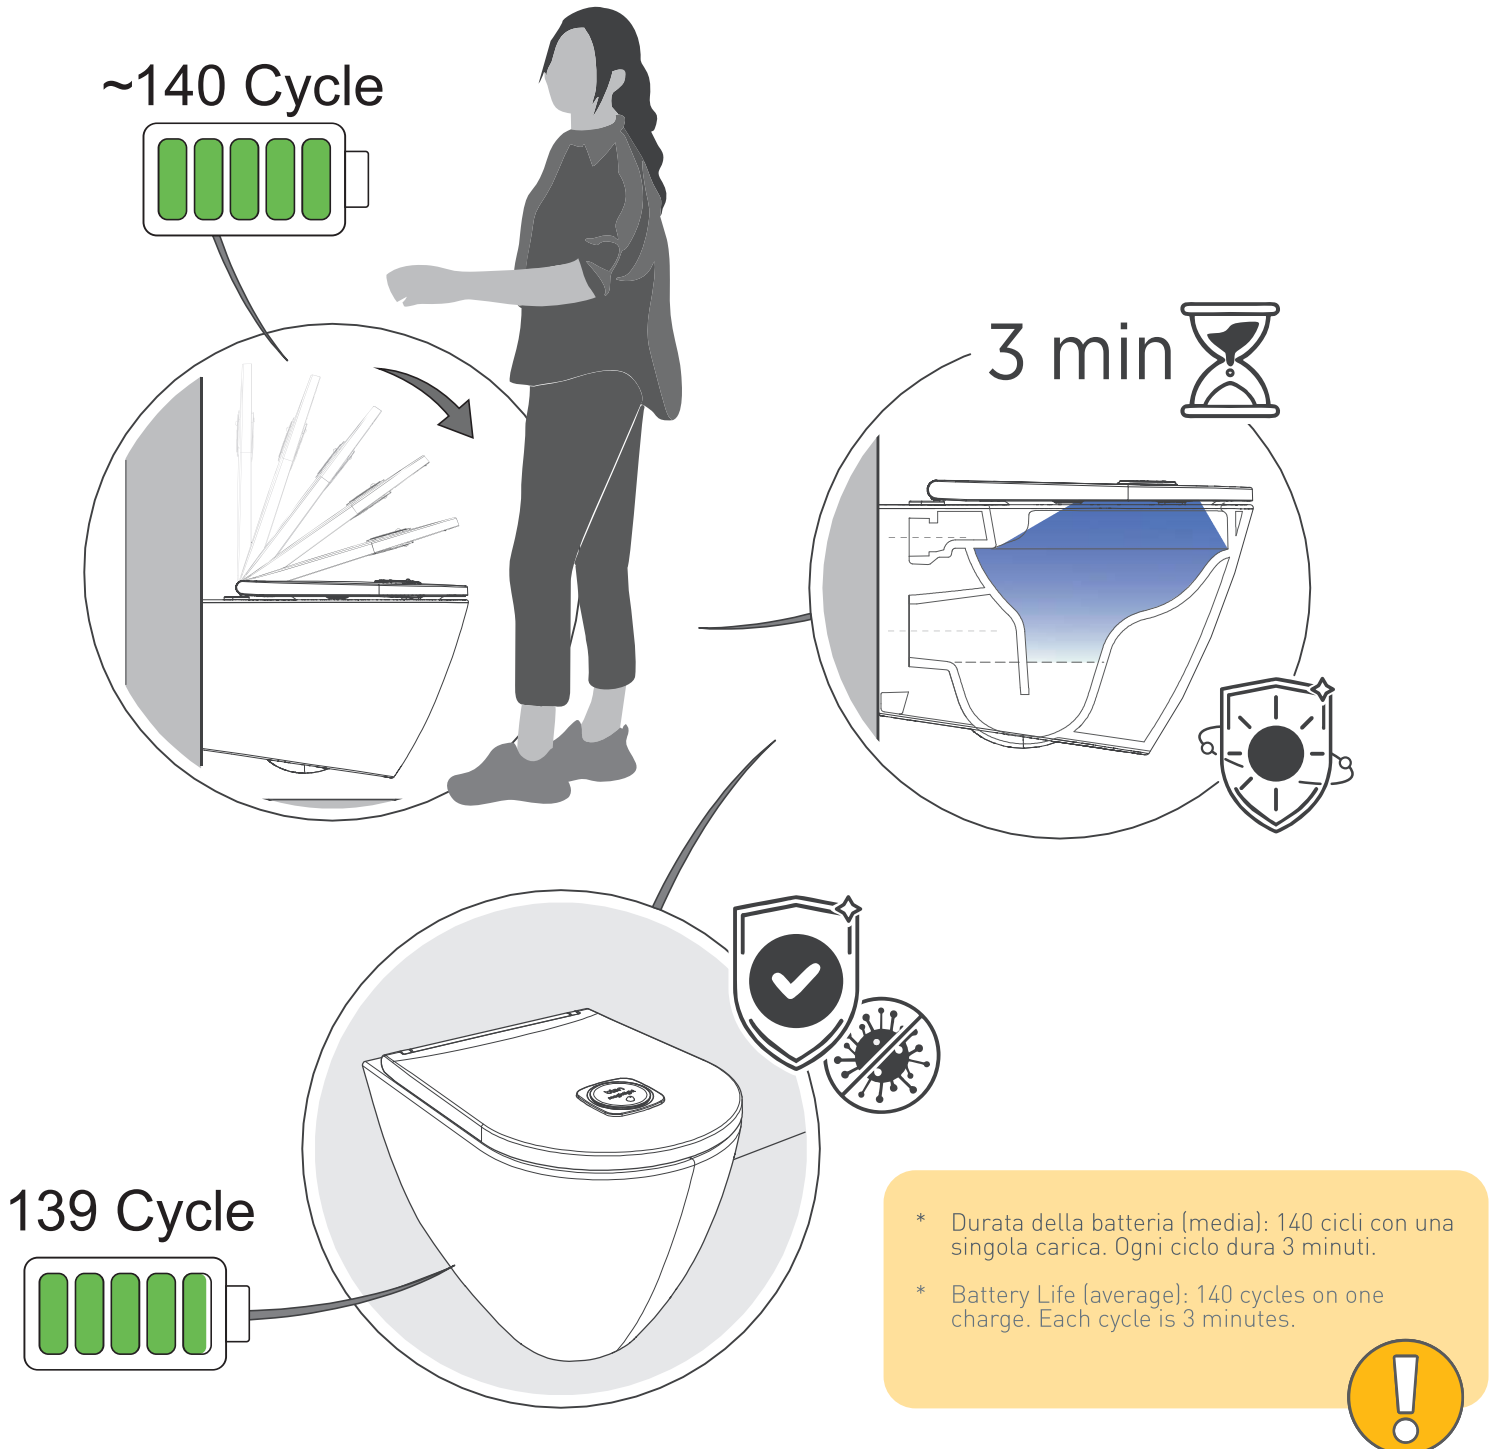


## THE.MAGICLIGHT

Istruzioni di Montaggio | Dispositivo di Irradiazione Antisettica a Raggi Ultravioletti  
Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

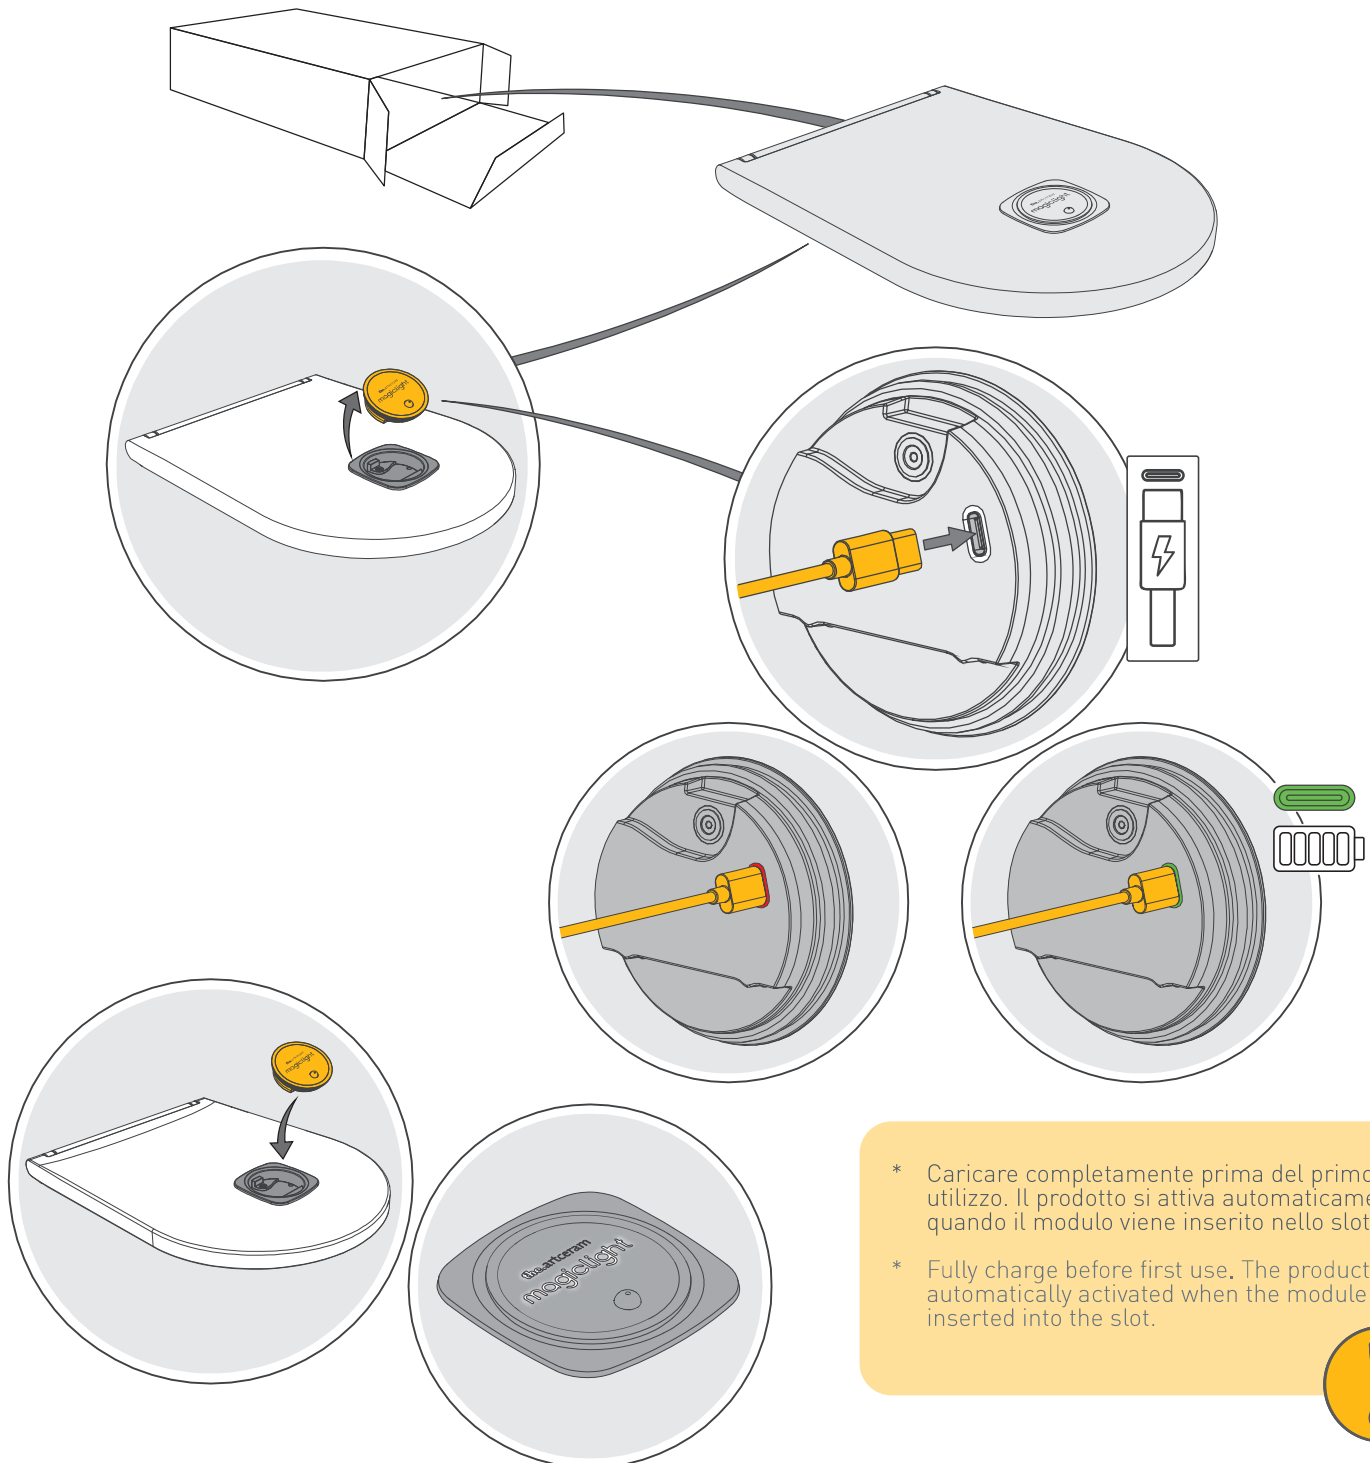


## THE.MAGICLIGHT

Istruzioni di Montaggio | Dispositivo di Irradiazione Antisettica a Raggi Ultravioletti  
Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

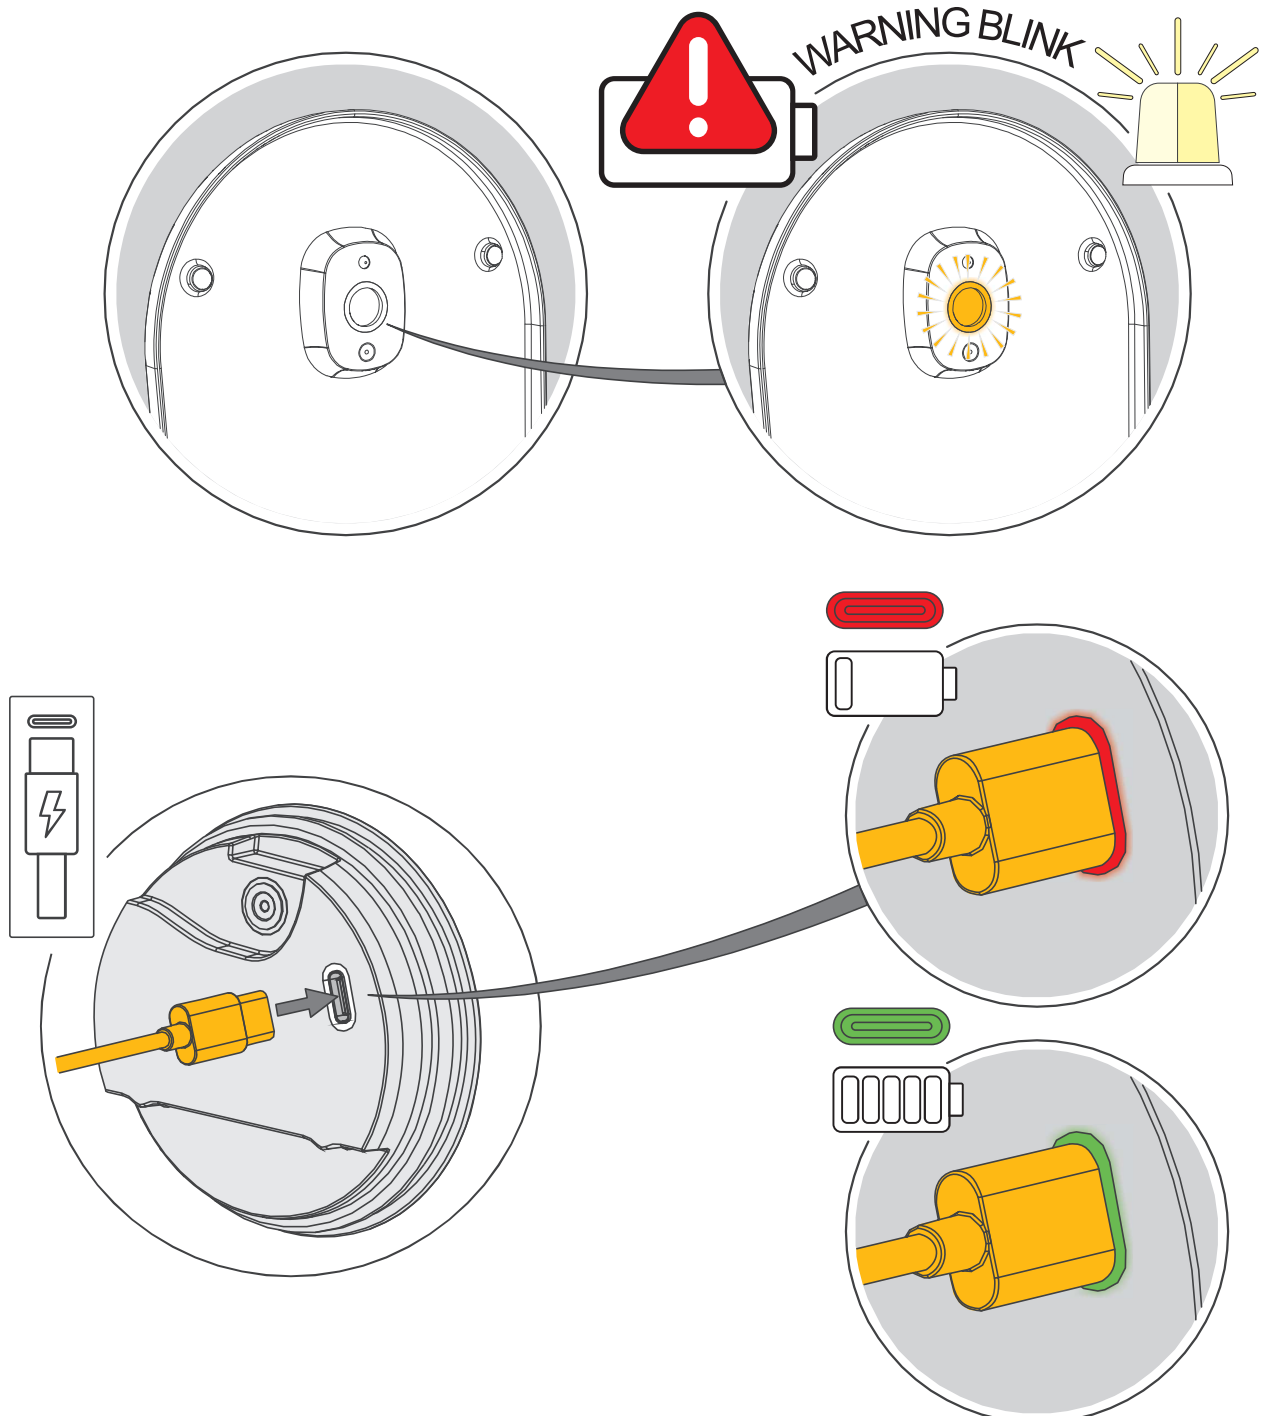


## THE.MAGICLIGHT

Istruzioni di Montaggio | Dispositivo di Irradiazione Antisetica a Raggi Ultravioletti  
Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

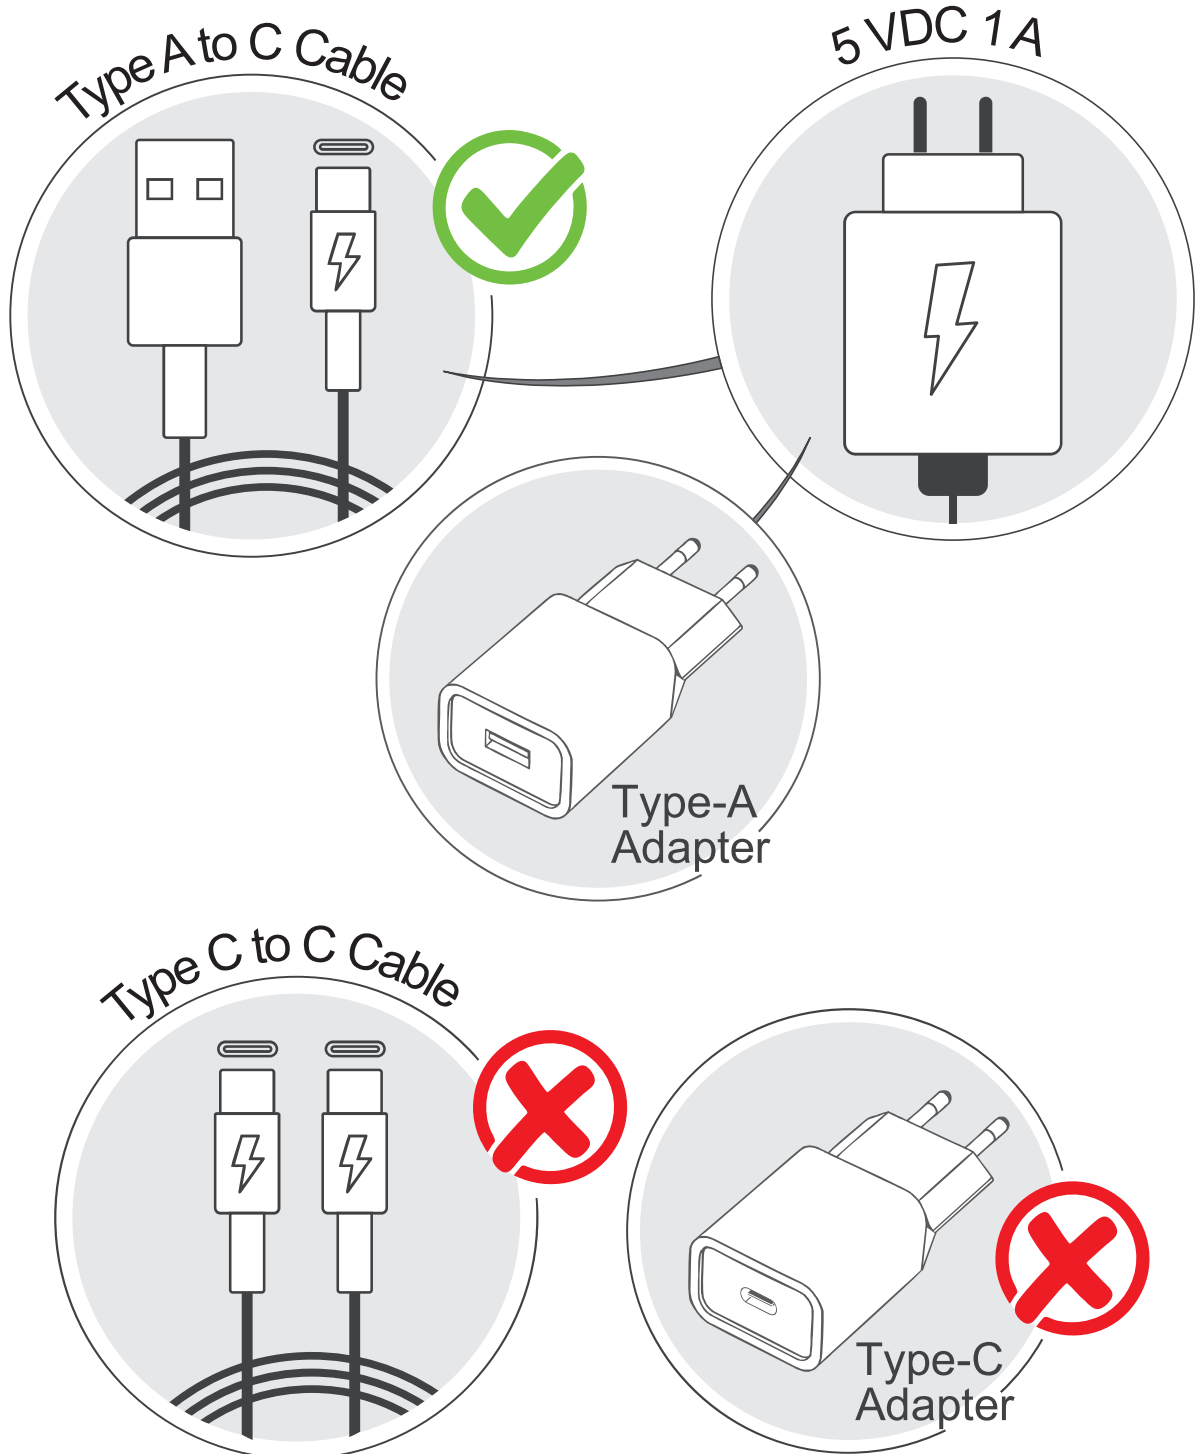

## THE.MAGICLIGHT

Istruzioni di Montaggio | Dispositivo di Irradiazione Antisetica a Raggi Ultravioletti  
Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

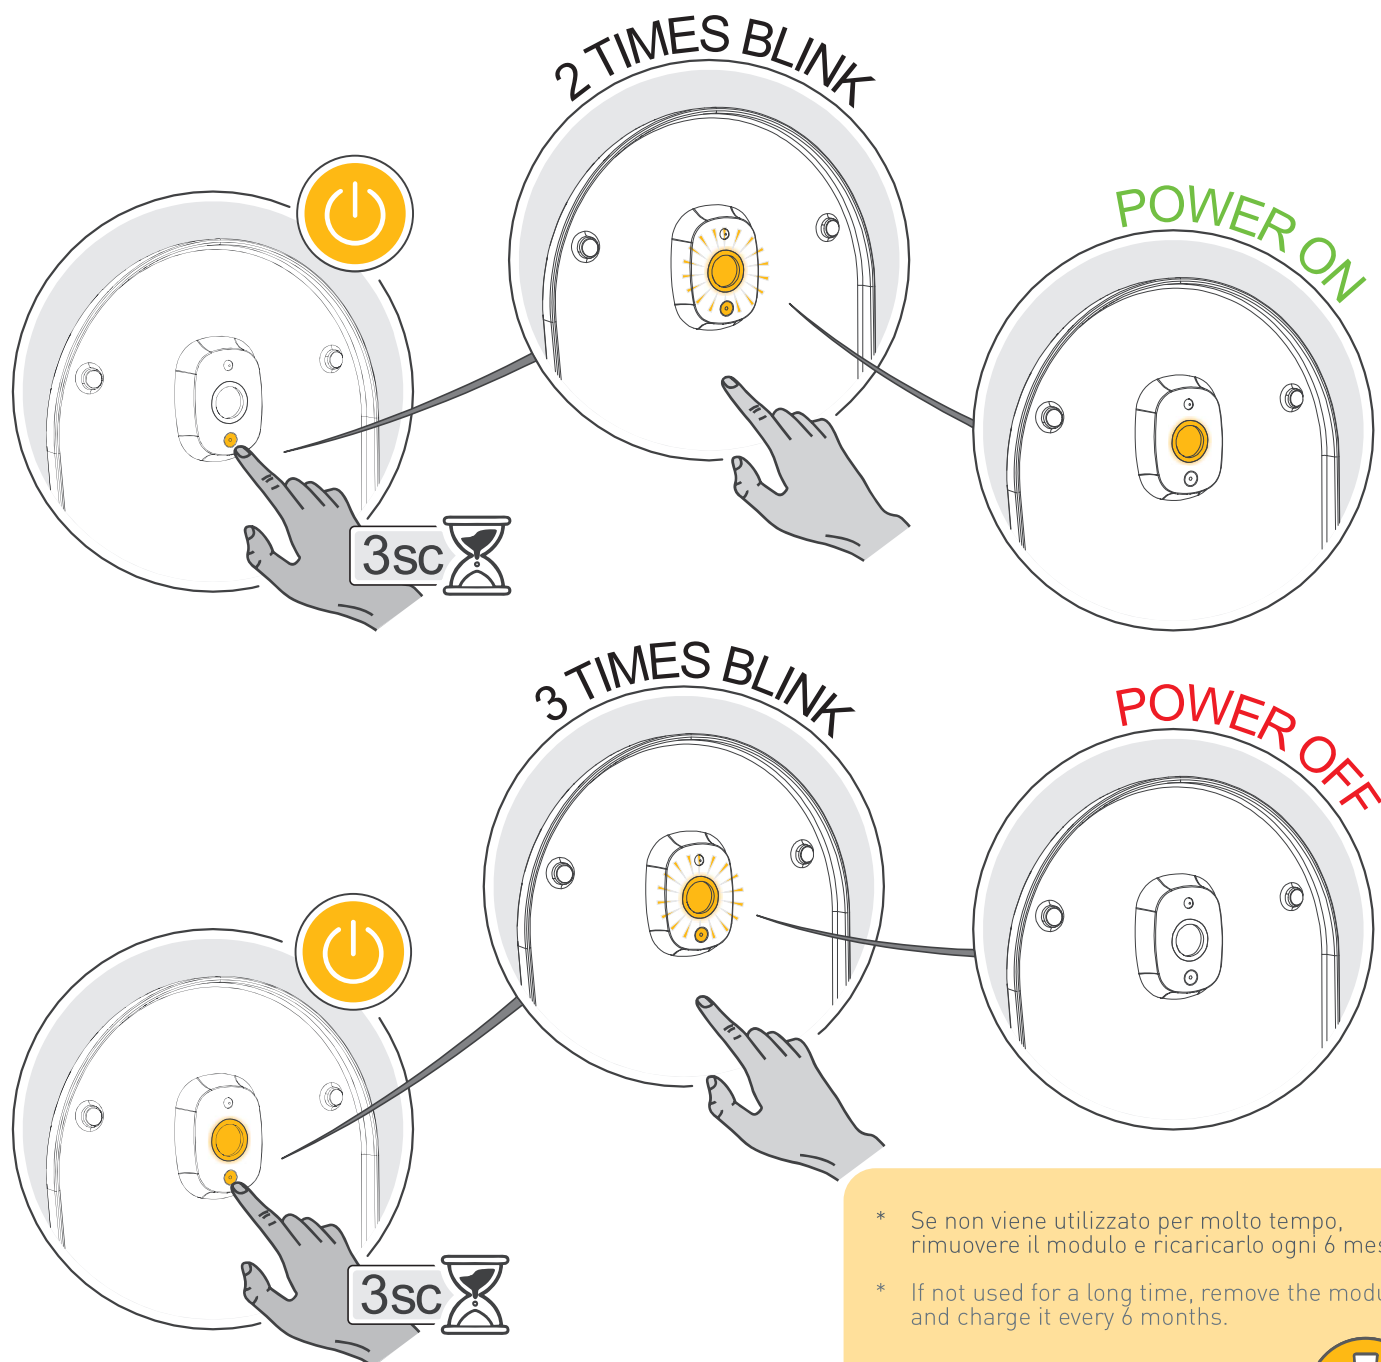


- \* Se non viene utilizzato per molto tempo, rimuovere il modulo e ricaricarlo ogni 6 mesi.
- \* If not used for a long time, remove the module and charge it every 6 months.




## THE.MAGICLIGHT

Istruzioni di Montaggio | Dispositivo di Irradiazione Antisetica a Raggi Ultravioletti  
Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

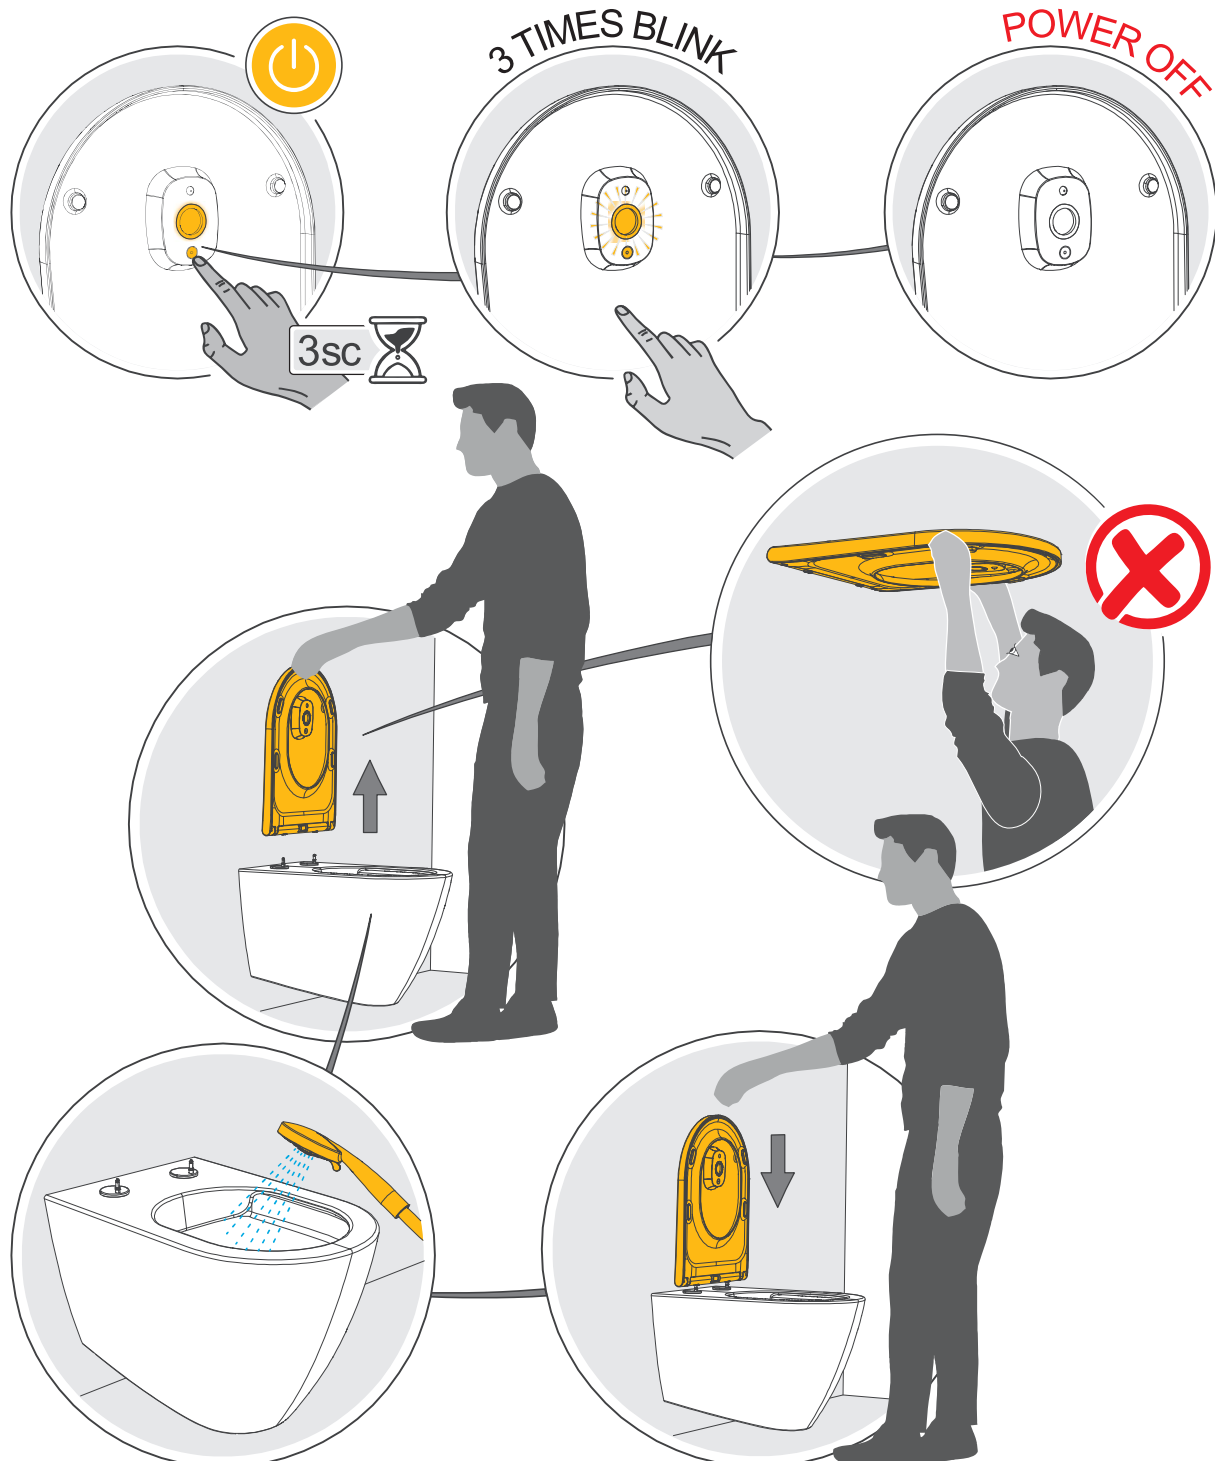




## THE.MAGICLIGHT

Istruzioni di Montaggio | Dispositivo di Irradiazione Antisettica a Raggi Ultravioletti  
Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

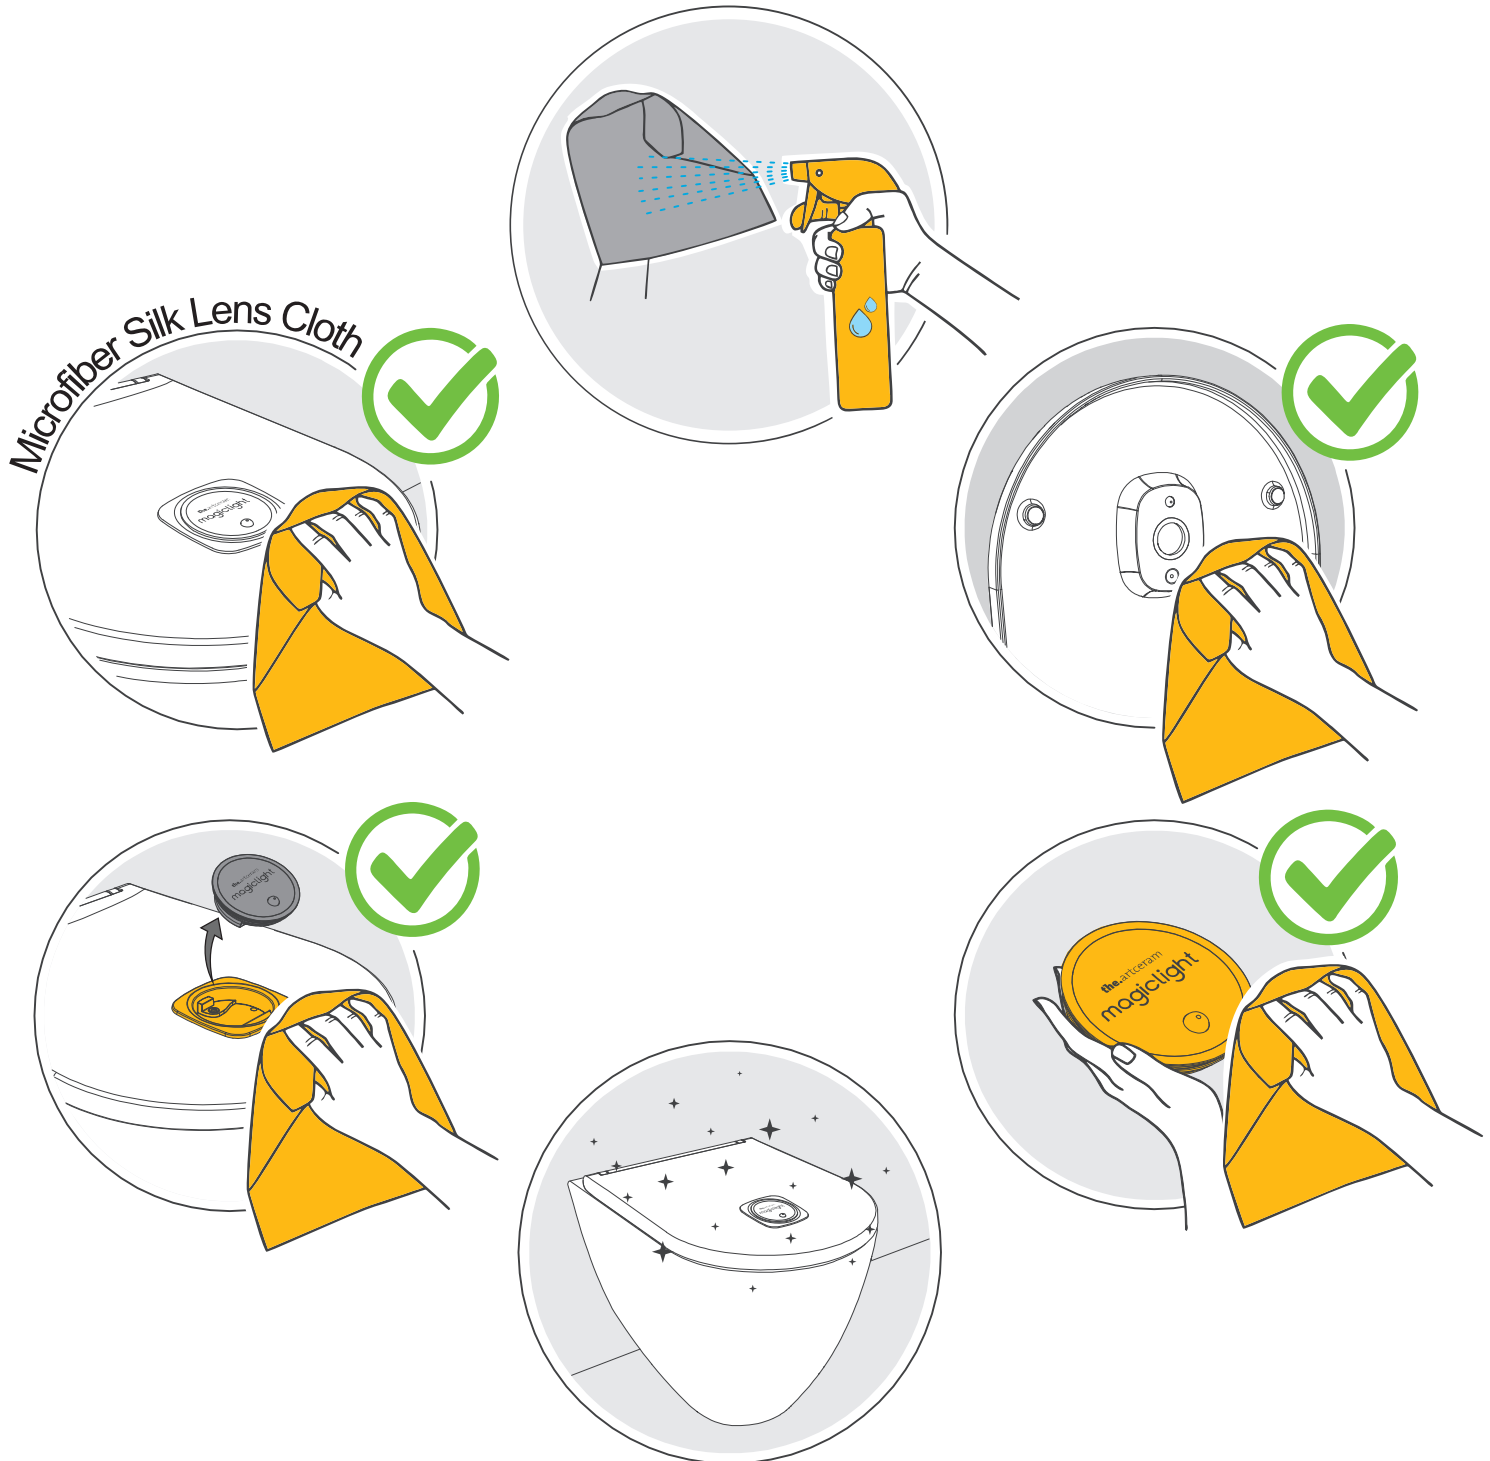

## THE.MAGICLIGHT

Istruzioni di Montaggio | Dispositivo di Irradiazione Antisettica a Raggi Ultravioletti  
Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

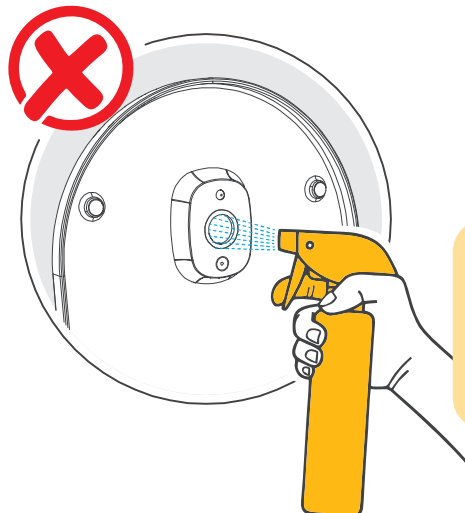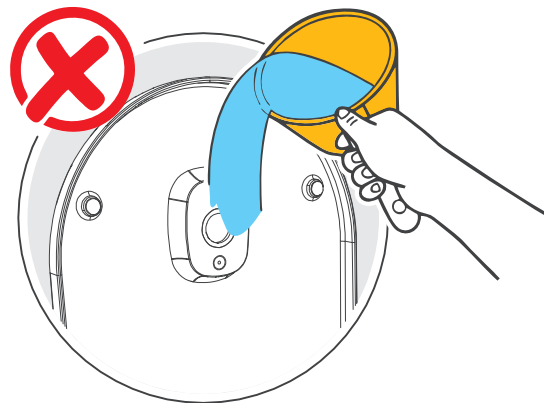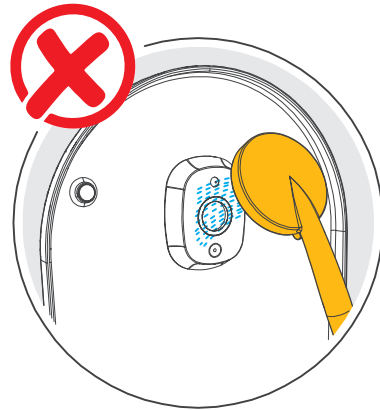

- \* Evitare il contatto con l'acqua.
- \* Avoid contact with water.

